


## 生物成像平台一部分仪器使用流程图

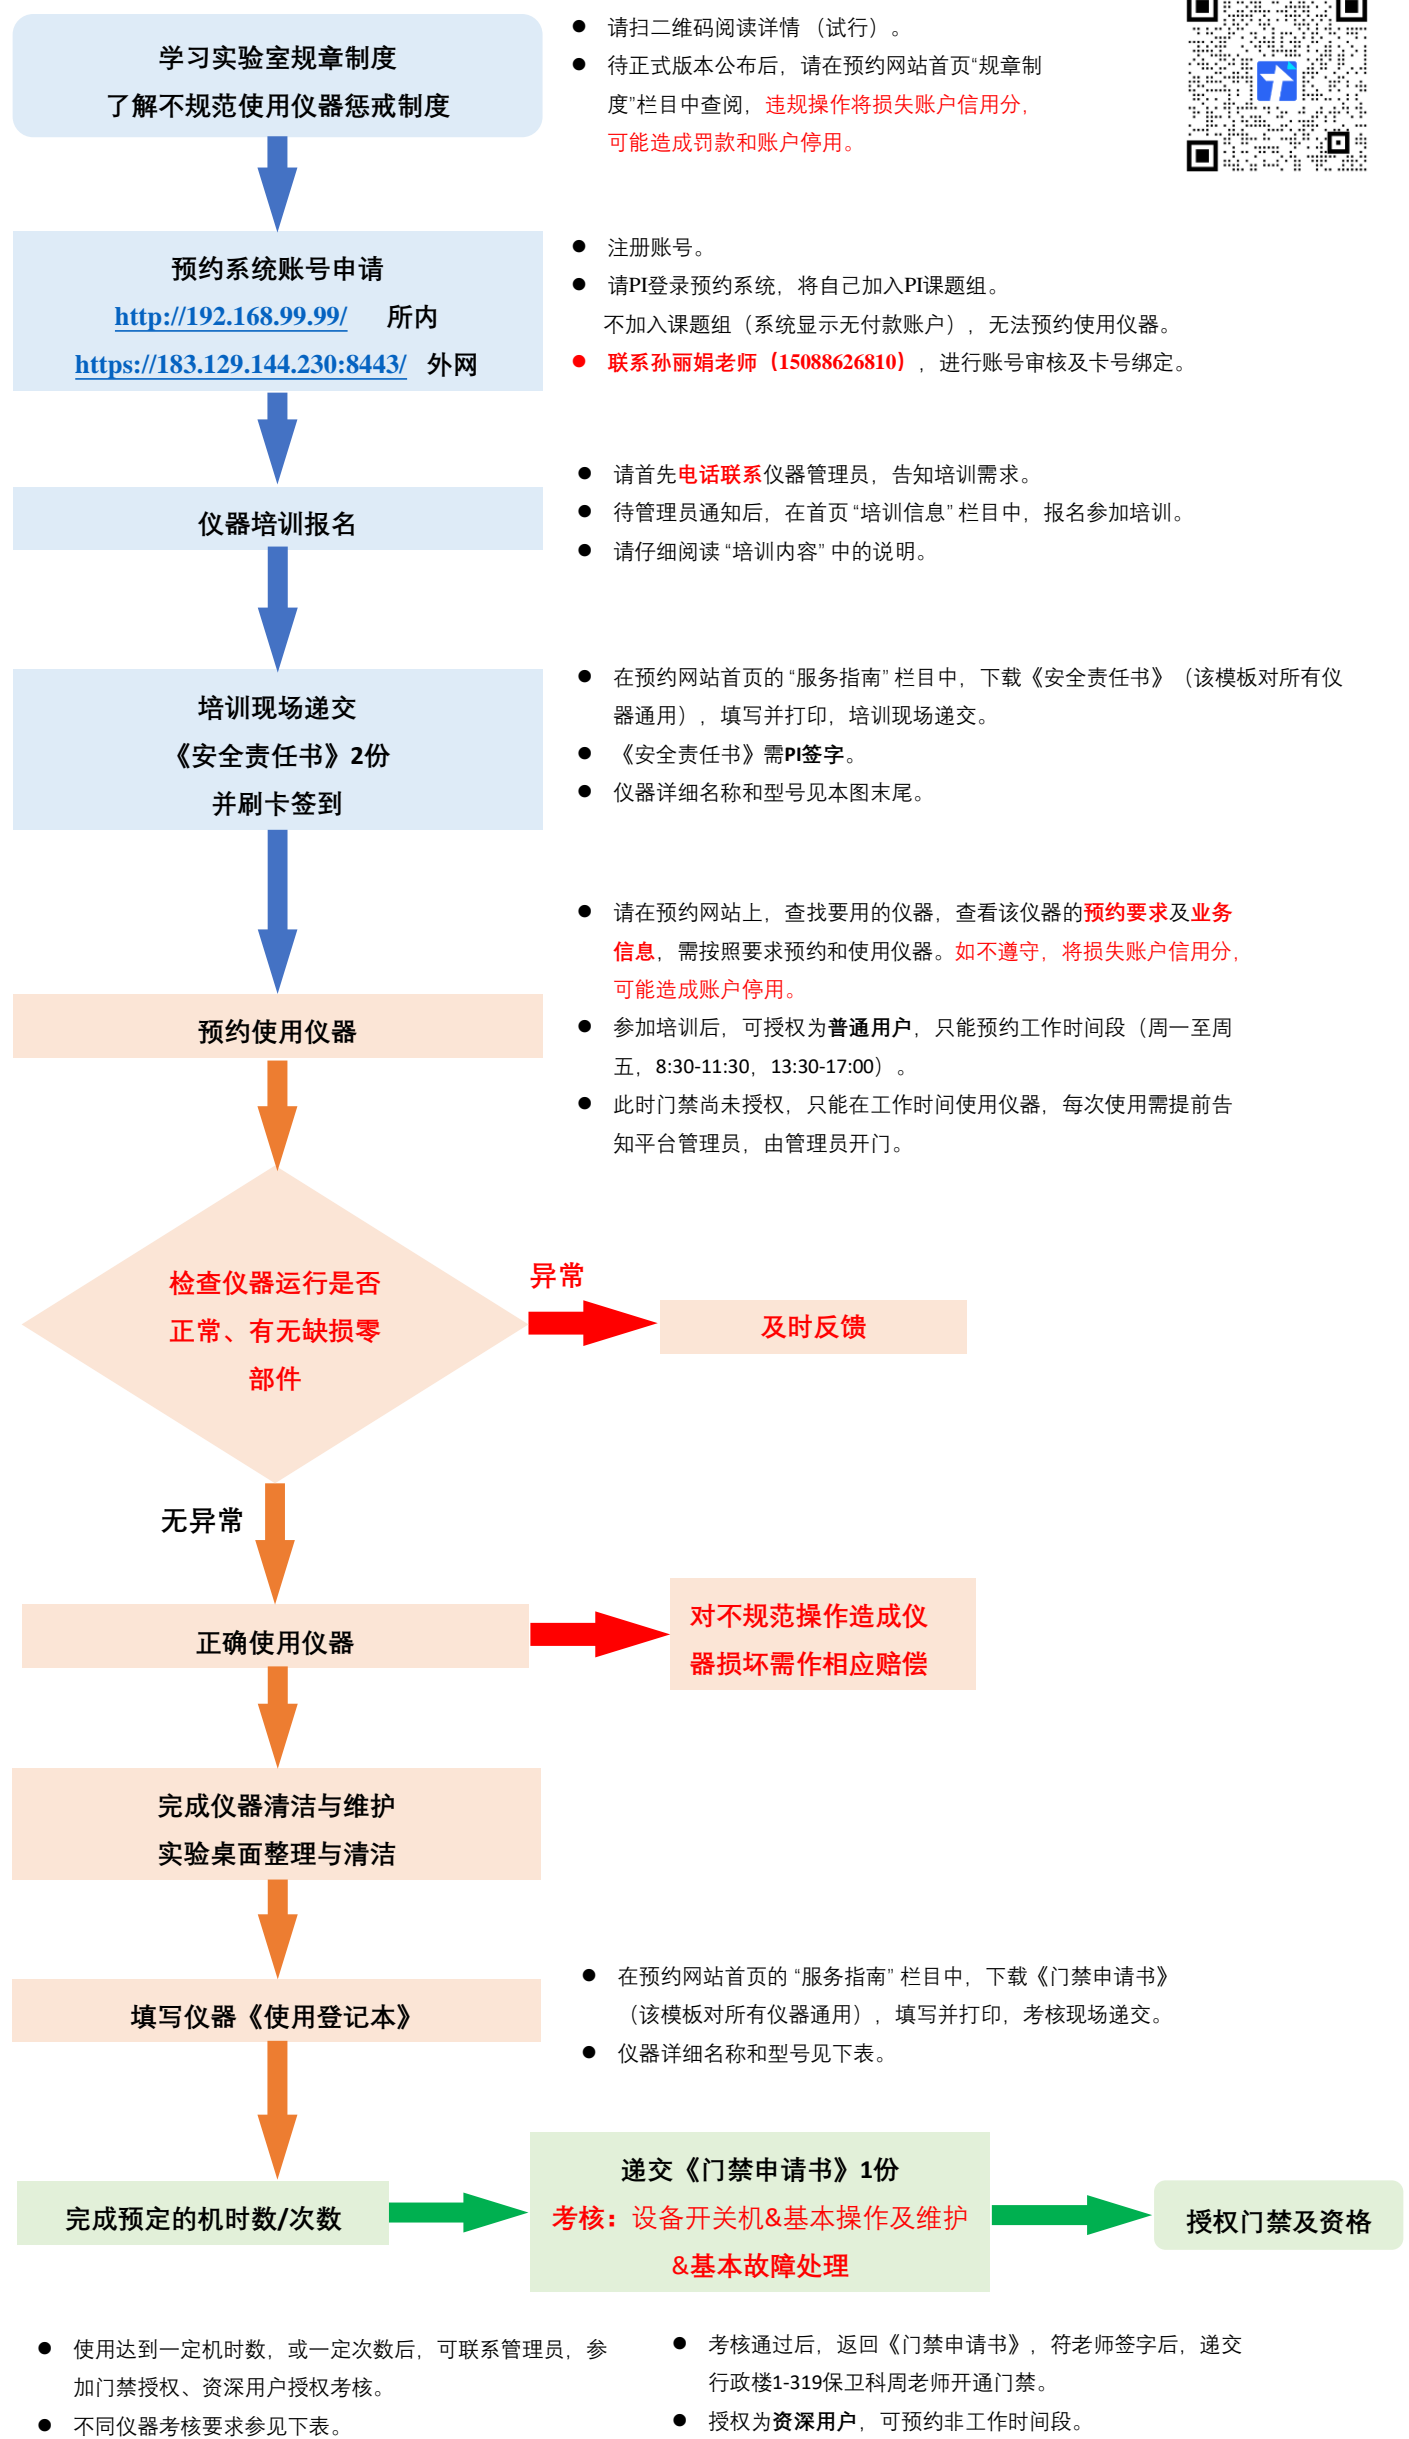

## 生物成像平台一部分仪器列表

编号	仪器设备名称	管理员	考核要求	落位地点
1	流式细胞分析仪CytoFLEX LX-3-301 Beckman Coulter	杨彤 18888921321	10 h	3-301
2	纳米流式检测系统-3-301 福流 U30		20 h	
3	酶标仪-3-301 Tecan		3次	
4	EnVision2105酶标仪 PE		3次	3-308
5	荧光定量PCR仪-1号机-3-308 Roche LC96		3次	
6	荧光定量PCR仪-2号机-3-308 Roche LC96		3次	
7	BD单细胞测序系统 BD Rhapsody		5次	3-310
8	单光子共聚焦显微镜-3-311 Nikon A1 HD25		20 h	3-311
9	单光子共聚焦显微镜-3-201 Nikon A1 RHD25 Model		20 h	3-201
10	单分子TIRF成像系统 Olympus Cell TIRF		20 h	3-311
11	转盘共聚焦显微镜 Nikon CSU-W1-SoRa		20 h	
12	实时荧光高通量检测系统 MD FLIPR		5次	3-316
13	流式细胞分选仪-3-314 Beckman Coulter MoFlo Astrios EQs		30 h	3-314
14	组织成像质谱流式系统 Fluidigm Hyperion		30 h	3-107
15	TIRF图像处理工作站		无	3-313
16	Nikon图像处理工作站-1		无	3-302
17	Nikon图像处理工作站-2		无	