


小动物成像仪 Biospace OPTIMA 使用注意事项

1. BLI 拍照全过程: 采集界面的 illuminator 设置**严禁**高过 9%
 2. FLI 拍照 Preview 过程: 采集界面的 illuminator 设置**严禁**高过 9%
- 【注意】: Illuminator 设置错误会损伤感光元件**

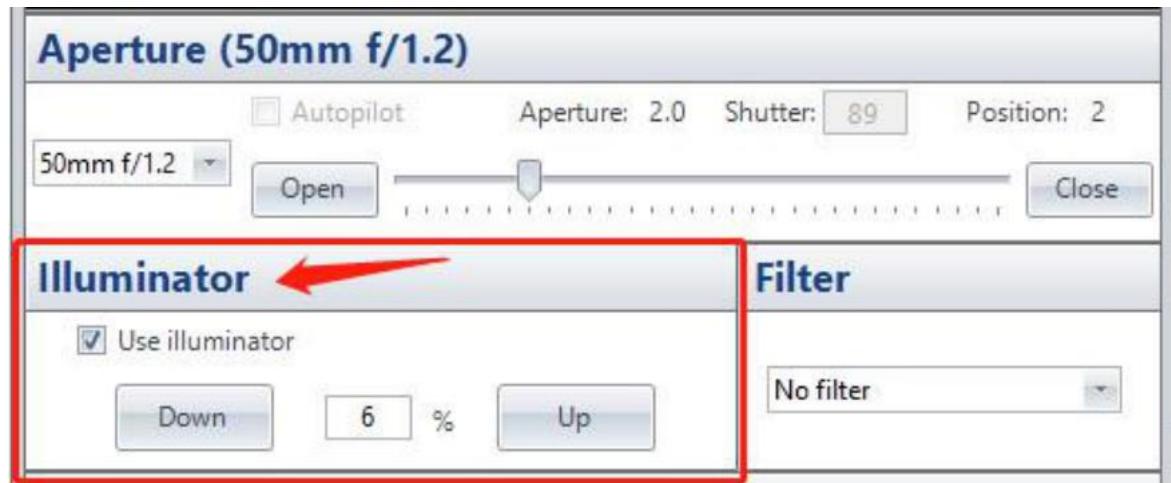

3. 文档 save、软件 Acquisition 和 M3Vision 同时开启使用, 等过程中, 会出现短暂卡顿状态, 请勿点击鼠标, 等待加载完成 (光标滑动流畅) 后, 再使用。
4. 设备上存在副屏 (含有部分软件和设备设置模块), 因此电脑主屏上看不见鼠标指针时, 请不要着急点击鼠标, 多次重复向左 (电脑主屏方向) 滑动鼠标后, 寻找鼠标指针。

5. 移动载台时需要提前检查，确保载台上方及周围（进气管和出气管等结构），没有东西会撞到相机或暗室顶部后才可移动。

6. 载台移动时，请勿直接点击软件上方的 UP 键，建议缓慢滑动下方的升降滑块寻找合适的成像高度。

**【注意】：载台高度（Stage）仅用于调节成像视野大小
如果是想调焦距，通过下方的 Focus 选项来调节**

7. 载台清洁：严禁直接对暗室或载台喷洒酒精，应酒精喷湿纸巾后，由纸巾擦拭。

8. 若涉及细胞或组织拍照，请勿打开培养皿或培养板的盖子，以免污染设备内环境，造成生物污染。

9. 仪器使用过程严禁触碰设备触屏。

10. 实验结束后请如实登记实验信息。

11. 未经授权，严禁自行安装任何软件，严禁更新电脑系统。

12. 无独立操作资格者在未获得仪器管理员允许下严禁自行操作仪器。

13. 仪器出现报错，请及时手机拍摄报错信息，并及时上报仪器管理员。

